

MAINTENANCE DE LA BAG

NETTOYAGE DE LA BAG

Le nettoyage des fenêtres extérieures peut se faire à l'aide d'un linge doux imbibé de détergent de type WINDEX (ÉVITER L'UTILISATION DE PUISSANTS DÉTERGENTS).

L'intérieur de la BAG peut être nettoyés avec une brosse et un aspirateur, l'usage de détergent ou de solvant est à éviter.

GANTS

Les gants doivent être inspectés de manière régulière pour déceler d'éventuels trous source de fuite et de contamination de la BAG.

ANTICHAMBRE

Vérifier les joints d'étanchéité des portes des sas des petites antichambres ainsi que de la grande, les remplacer s'ils sont endommagés.

MBRAUN PART NUMBER 2400171 O-RING FOR MINI-ANTECHAMBER COVER.

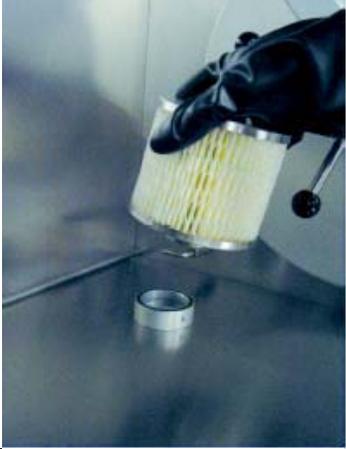
MBRAUN PART NUMBER 2400309 O-RING FOR ANTECHAMBER INSIDE AND OUTSIDE.

Si le mécanisme d'ouverture des portes des antichambres est bloqué, on peut utiliser de la graisse ou un lubrificateur au niveau du mécanisme extérieur d'ouverture.

CHANGEMENT DES FILTRES DE POUSSIÈRE

MBRAUN PART NUMBER 9004513 DUST FILTER (MB-BF-L-03)

LES FILTRES À POUSSIÈRE ONT BESOIN D'ÊTRE CHANGÉ ANNUELLEMENT.

	<p><u>ÉTAPE 1</u></p> <p>DÉVISSER LE VIEUX FILTRE</p>
	<p><u>ÉTAPE 2</u></p> <p>VISSER LE NOUVEAU FILTRE</p>

IL NE FAUT PAS JETER LES FILTRES USÉS À LA POUCELLE, LES PLACER DANS UN SAC DE POUCELLE NOIR, METTRE UNE ÉTIQUETTE INDIQUANT FILTRES À POUSSIÈRE CONTAMINÉS AVANT DE LES REMETTRE À LA COLLECTE DE DÉCHETS CHIMIQUES.

CHANGEMENT DE LA TRAPPE À SOLVANT

MBRAU PART NUMBER: 2182000 ACTIVATED CHARCOAL (5.5kg)

IL EST RECOMMANDÉ DE CHANGER LE CHARBON ACTIVÉ DE LA TRAPPE À SOLVENT ANNUELLEMENT, SI LA B.A.G EST UTILISÉ DE MANIÈRE PLUS INTENSE, IL FAUDRAIT CHANGER LE CHARBON PLUS RÉGULIÈREMENT.

1. CHANGER LE SYSTÈME DE PURIFICATION DE GAS EN MODE "BYPASS" EN PROCÉDANT DE LA MANIÈRE SUIVANTE:

- OUVRIR LA VALVE 3
- FERMER LA VALVE 1
- FERMER LA VALVE 2
- VALVE 4 EN POSITION "CLOSED"

2. OUVRIR LA BRIDE "FLANGE" (OUT) DE LA TRAPPE À SOLVANTS, ENSUITE VIDER LE CONTENU (CHARBON CONTAMINÉ) DANS UNE BASSINETTE.

IL FAUT DISPOSER DU CHARBON ACTIVE SELON LES RÉGLES ÉTABLIT PAR LA SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL DE L'UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

3. APRÈS AVOIR FINI DE VIDER LE CONTENU DE LA TRAPPE À SOLVANTS, FERMER LA BRIDE DE SORTIE (OUT) ENSUITE OUVRIR LA BRIDE D'ENTRÉE (IN).

4. REMPLIR AVEC LE NOUVEAU CHARBON ACTIVÉ (5 Kg), ENSUITE FERMÉ LA BRIDE D'ENTRÉE.

5. METTRE LA VALVE 4 À LA POSITION "EVACUATE" (ENSUITE IL FAUT ATTENDRE AU MOINS 6 HEURES).

6. APRÈS L'ÉVACUATION, METTRE LA VALVE 4 EN POSITION "REFILL", ATTENDRE JUSQU'À CE QUE LA PRESSION INDIQUÉ PAR LE MANOMÈTRE INDIQUE 0.

7. UNE FOIS LE REMPLISSAGE "REFILL" TERMINÉ, METTRE LA VALVE 4 EN POSITION "CLOSED".

TRAPPE À SOLVENT EST ALORS DE NOUVEAU OPÉRATIONEL.